

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
dostawę sprzętu jednorazowego użytku
W.Sz.S/DAZ/2411/P-8/065/2470/13

WYJAŚNIENIA treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 .

Zgodnie z art. 22.1.1 PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Informujemy, iż glukometry i paski testowe są klasyfikowane jako wyroby medyczne (nie leki) , przepisy prawa nie wymagają posiadania specjalnej koncesji/zezwolenia na obrót wyrobami medycznymi. W związku z powyższym chcieliśmy spytać czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty i wykonania zamówienia Wykonawcę , który nie posiada zezwolenia na hurtowy obrót lekami (tzn. nie jest hurtownią farmaceutyczną) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 –dotyczy Części 23


Czy Zamawiający dopuści test paskowy z „bocznym” polem pomiarowym, które utrudnia lub uniemożliwia dokonanie pomiaru z innego miejsca niż opuszek palca (np. próbówka, naczynie) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 3–dotyczy Części 23

Czy Zamawiający wymaga aby pole pomiarowe paska znajdowało się w jego przedniej części ?
Dla ułatwienia podajemy przykłady testów z przednim i bocznym polem pomiarowym :

Przykład testu z „przednim” polem pomiarowym :

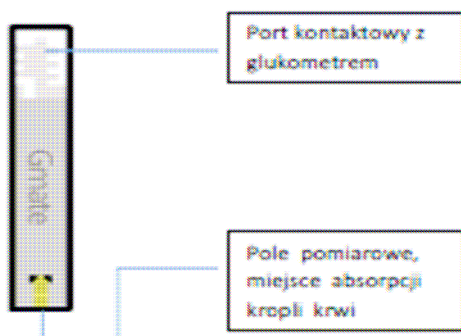

Przykład testu z „bocznym” polem pomiarowym :



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 –dotyczy Części 23

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający ma na myśli 1340 szt. pasków czy też 1340 opakowań pasków pakowanych po 50 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1340 opakowań pasków pakowanych po 50 sztuk.

Pytanie 5 –dotyczy Części 23

Zamawiający określając przedmiot zamówienia napisał : paski typu iXell. Jednocześnie Zamawiający dopuścił inny rodzaj pasków przy czym zaznaczył, iż enzym zawarty na pasku powinien być odporny na poddawanie się wpływowi czynników zakłócających pomiar glukozy we krwi bez wskazania norm, zakresów itp. Z daleko idącej ostrożności chcieliśmy zatem spytać czy Zamawiający dopuści paski testowe z enzymem - oksydaza glukozy „GOD” – takim samym jaki znajduje się na paskach iXell (nie interferuje znacząco z : maltozą, galaktozą, tlenem we krwi kapilarnej, współczynnik korekty hematokrytu wynosi 20-60 %). ? Enzym „oksydaza glukozy” jest wszechstronnie używany, również przez urządzenia referencyjne np. YSI 2300. Parametry oferowanych przez naszą firmę pasków są lepsze lub takie same jak w przypadku pasków iXell (np. szybszy czas pomiaru = 5 s, mniejsza kropla krwi = 0,5 mcl) .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6–dotyczy Części 23

Prosimy o uściślenie parametru dokładności pasków. Zamawiający wymaga aby dokładność mieściła się w zakresie +- 10 % ale nie wskazuje na inne parametry biorące udział w ocenie dokładności tj. % wyników, zakres stężenia glukozy, rodzaj próbki krwi itp. Chcieliśmy zatem spytać, czy Zamawiający dopuści jedynie tak dokładne systemy pomiarowe, których minimum 90 % wyników dla stężeń glukozy ≥ 75 mg/dL (próbka krwi pobrana z palca) mieściło się w w zakresie +- 10 % w porównaniu z wynikami uzyskanymi na urządzeniu referencyjnym ? Dla przykładu podajemy parametry dokładności 6 wybranych systemów pomiarowych w porównaniu do urządzeń referencyjnych, które znaleźliśmy w ulotkach producentów (próbka krwi pobrana z palca) :

- | | |
|---|---|
| a/ Care Sens N (i-Sens, enzym GOD) –
zakresie +- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 96 % wyników mieściło się w |
| b/ Gmate (Philosys, enzym GOD) –
zakresie +- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 95 % wyników mieściło się w |
| c/ Accu-Chek-Active (Roche, enzym GDH-PQQ) –
+- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 93 % wyników mieściło się w zakresie |
| d/ Wellion Calla (Med Trust, enzym GOD) -
zakresie +- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 86 % wyników mieściło się w |
| d/ Accu-Chek Performa Nano (Roche, enzym GDH-PQQ) –
+- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 82 % wyników mieściło się w zakresie |
| e/ GlucoDr (Allmedicus, enzym GDH-FAD) –
zakresie +- 10 % dla stężeń ≥ 75 mg/dL | 78 % wyników mieściło się w |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczy Części 5 ,poz. 4

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jaki model aparatu posiadacie. Czy chodzi o aparat Biopty?

Odpowiedź: Igła biopsyjna kompatybilna z aparatem – pistoletem BARD MAGNUM REF MG 1522.

Pytanie 8 –dotyczy Części 6

1.Czy nie nastąpił przy podaniu producenta aparatu USG?.

Odpowiedź : Producent PHILIPS.

2.Prosimy o podanie modelu głowicy oraz informacji odnośnie producenta posiadanej przystawki.

Odpowiedź: Głowica –Model C 5-2- firmy PHILIPS , przystawka – producent CIVCO.

Pytanie 9 –dotyczy Części 23

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu w części nr 23 paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi GlucoDr auto, charakteryzujące się następującymi parametrami: deklarowane przez producenta spełnienie wymogów normy ISO15197 i zaleceń PTD z roku 2013 co do błędu oznaczenia, szeroki zakres pomiarowy 10-900mg/dl, automatyczne kodowanie, wyrzut paska po wykonanym pomiarze, zakres hematokrytu 20-60%, enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD nie reagujący krzyżowo z cukrami nie-glukozowymi i tlenem, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska testowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10- dotyczy wzoru umowy.

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę), Zamawiający wprowadzi do umowy zapis: „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?”. Zmiany stawek VAT są zupełnie niezależne od Wykonawcy, oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Wykonawca nie może skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki VAT. Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT par.8 pkt.1.3) projektu umowy. stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 – dotyczy Część 18, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta. Chcemy podkreślić, że na rynku są oferowane produkty, które pomimo tego, że w wewnętrznej warstwie posiadają włókninę paroprzepuszczalną, zewnętrzną warstwę mają wykonaną z materiału nieprzepuszczającego powietrze, często tym materiałem jest folia nieoddychająca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczy Część 18, poz. 1-4

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała oraz posiadający falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 – dotyczy Część 19

Czy zamawiający nie pomylił się w podawaniu ilości w pakiecie nr 19? Podane wartości zdają się być małe biorąc pod uwagę, że umowa ma być podpisana na okres 5 miesięcy.

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 14 – dotyczy Część 19, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowana pieluchomajtek ze specjalnym wycięciem na kikut pępownicy, który chroni to delikatne miejsce przed podrażnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek ze specjalnym wycięciem na kikut pępownicy, który chroni to delikatne miejsce przed podrażnieniem.

Pytanie 15- dot. wzoru umowy:

1. Jaką wartość umowy zamawiający na pewno zrealizuje? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu były dołączone do oferty, a nie wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby uzupełnienie braków ilościowych następowało w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 5 wzoru umowy dopisać słowa „, ,
chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania

Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 7 ust.

5 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy słowa „pod warunkiem niezmienności cen brutto” zostały zastąpione słowami „pod warunkiem niezmienności cen netto”? Zwrot w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy „pod warunkiem niezmienności cen brutto” jest prawdopodobnie wynikiem omyłki Zamawiającego. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT musi spowodować zmianę ceny brutto; bez zmian może pozostać cena netto. Dlatego uzasadniona jest zmiana zapisu w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy dodać podpunkt 14) o następującej (lub podobnej) treści: „dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku zwłoki w dostawie naliczana była od wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki (§ 10 ust. 1 pkt a))?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16-dotyczy Części 23

1.Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty w części nr 23 Wykonawcę, który nie posiada zezwolenia na hurtowy obrót lekami, co może powodować przewożenie leków w niewłaściwych warunkach oraz niewłaściwej temperaturze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.Pytanie dotyczy części 23, mając na uwadze wiarygodność i dokładność glukometrów i pasków zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do przetargu nier refundowane paski do glukometrów, które nie są sprawdzone przez MZ i NFZ pod względem posiadanych badań, certyfikatów. Brak na listach refundacyjnych świadczy o „niedopełnieniu dokumentacji”, co wskazuje na brak wiarygodności pasków i podważa ich wyniki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17- dotyczy Części 14

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi, dopuści w zakresie pakietu nr 14 złożenie oferty z zestawami do cewnikowania żył centralnych metodą Selinagera wyposażonymi w nitynolowe przewodniki, z możliwością identyfikacji położenia cewnika zarówno w promieniach RTG jak również przy użyciu EKG, wyposażonymi w dwie igły wprowadzające o długości 5 i 7cm i średnicy 18G, skalpel, rozszerzacz dostosowany do średnicy cewnika oraz strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez jej odłączania, w rozmiarach przedstawionych w poniższych tabelach?

Cewniki 1 światłowe

Kod produktu	Cewnik		G/światło
	Rozmiar	Długość	Centralny
CV+SL0515K	5Fr	15 cm	17
CV+SL0517K	5Fr	17 cm	17
CV+SL0520K	5Fr	20 cm	17
CV+SL0615K	6Fr	15 cm	16
CV+SL0617K	6Fr	17 cm	16
CV+SL0620K	6Fr	20 cm	16
CV+SL0715K	7Fr	15 cm	15
CV+SL0717K	7Fr	17 cm	15
CV+SL0720K	7Fr	20 cm	15

Kod	Cewnik		G/światło
CV+SL0815K	8Fr	15 cm	14
CV+SL0817K	8Fr	17 cm	14
CV+SL0820K	8Fr	20 cm	14

Cewniki 2 światłowe

Kod produktu	Cewnik		G / światło	
	Rozmiar	Długość	Dystalny	Centralny
CV+DL0515KN	5Fr	15 cm	20	20
CV+DL0517KN	5Fr	17 cm	20	20
CV+DL0520KN	5Fr	20 cm	20	20
CV+DL0615KN	6Fr	15 cm	18	18
CV+DL0617KN	6Fr	17 cm	18	18
CV+DL0620KN	6Fr	20 cm	18	18
CV+DL0715KN	7Fr	15 cm	17	17
CV+DL0717KN	7Fr	17 cm	17	17
CV+DL0720KN	7Fr	20 cm	17	17
CV+DL0815KN	8Fr	15 cm	16	16
CV+DL0817KN	8Fr	17 cm	16	16
CV+DL0820KN	8Fr	20 cm	16	16

Cewniki 3 światłowe

Kod produktu	Cewnik		G/światło		
	Rozmiar	Długość	Dystalny	Centralny	Proksymalny
CV+TL0615K	6Fr	15 cm	20	16	20
CV+TL0617K	6Fr	17 cm	20	16	20
CV+TL0620K	6Fr	20 cm	20	16	20
CV+TL0715K	7Fr	15 cm	18	16	18
CV+TL0717K	7Fr	17 cm	18	16	18
CV+TL0720K	7Fr	20 cm	18	16	18
CV+TL0815K	8Fr	15 cm	17	14	16
CV+TL0817K	8Fr	17 cm	17	14	16
CV+TL0820K	8Fr	20 cm	17	14	16

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zestawów do cewnikowania naczyń centralnych dystrybuowanymi na rynku europejskim przez japońską firmę Terumo, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 –dotyczy Części 7

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 część 7 formularza asortymentowo-cenowego igły lokalizacyjnej typu „Z” o następujących parametrach:

Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21 G, długość w przedziale 5-7 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19- dotyczy Części 4

Proszę o dopuszczenie koreczków kombi i koreczków luer lock od innego producenta niż w poz. 1 i 2. Zamawiający tym wymogiem zablokował możliwość zaoferowania koreczków z trzpieniem, poniżej, które zapewniają większą aseptykę pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki kombi i koreczki luer lock od innego producenta niż w poz.1 i 2.

Pytanie 20-dotyczy Części 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 1 Cewnika centralnego jednoświatłowego dla dorosłych 18G/7F/20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21-dotyczy Części 14 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 2 Cewnika centralnego dwuświatłowego dla dorosłych 14.14Ga/7F/20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22-dotyczy Części 14 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 3 Cewnika centralnego dwuświatłowego dla dorosłych 14.14Ga/7,5 F/20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23-dotyczy Części 14 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 4 Cewnika centralnego trójświatłowego dla dorosłych 16.18.18Ga/7 F/20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, iemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24-dotyczy Części 14 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 5 Cewnika centralnego trójświatłowego dla dorosłych 16.18.18Ga/7 F/30 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało

ułatwiająca wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25-dotyczy Części 14 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 6 Cewnika centralnego czteroświatłowego dla dorosłych 14.16.18.18Ga/8,5 F/20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzało ułatwiająca wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, miękący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer - Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 5ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26-dotyczy Części 14 poz. 7

Zwracamy się o wydzielenie z Pakietu 14 pozycji 7, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względu na zwiększenie ilości ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27-dotyczy projektu umowy – § 9

W związku z postępowaniem przetargowym ogłoszonym przez Państwa jednostkę o nr 2013/s 165-286901 oraz brakiem zamieszczenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny brutto w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowy.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzenia oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%), przy obowiązku zachowania niezmiennego ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażąco strata po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w

trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28-dotyczy Części 28

Poz. 1 Maski nosowa

1. Czy maska nosowa ma posiadać okienko, które umożliwi wizualną kontrolę ułożenia maski i oceny ilości wydzielonego śluzu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maskę nosową posiadającą okienko, które umożliwi wizualną kontrolę ułożenia maski i oceny ilości wydzielonego śluzu .

2. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej.

Poz. 2 Końcówka donosowa

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej .

Poz. 3 Czapeczka do mocowania układu

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czapeczek wymiennie z paskowym mocowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czapeczek wymiennie z paskowym mocowaniem.

Poz. 4 Jednorazowe układy oddechowe

1. Czy Zamawiający ma na myśli układy oddechowe znane i atestowane przez producenta urządzenia CPAP Infant Flow, to znaczy takie, które posiadają pisemne potwierdzenie producenta o kompatybilności z użytkowanym przez Zamawiającego urządzeniem Infant Flow i jako takie będą bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego neonatologicznego o średnicy wew. rur 10 mm z generatorem wyposażonym w cztery dysze i mocowanym poprzez zaczep kołyskowy do czapeczki lub mocowania paskowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego neonatologicznego o średnicy wew. rur 10 mm z generatorem wyposażonym w cztery dysze i mocowanym poprzez zaczep kołyskowy do czapeczki lub mocowania paskowego.

3. Czy Zamawiający ma na myśli generator wykonany z przezroczystego tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza generator wykonany z przezroczystego tworzywa.

4. Czy układy oddechowe mają posiadać w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układy oddechowe posiadające w ramieniu wdechowym dodatkowy niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze.

Poz. 5 komora nawilżacza

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania komory nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą.

Pytanie 29-dotyczy Części 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 poz. 1 Martwa przestrzeń - rurka silikonowana o długości 180 cm z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F z podwójnym portem zatraskowym do odsysania 22F i bronchoskopu, sterylna z silikonową zatyczką otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 30-dotyczy Części nr 24, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 poz. 1 wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych i intubacyjnych z wkładem nawilżającym z portem do podawania tlenu (wysoka skuteczność nawilżania ≥ 26 mg H₂O/L dla vt 50 ml, waga 8g) z końcówką pasującą do maski tlenowej z drenem z zabezpieczeniem zapobiegającym uduszeniu pacjenta przy wzroście ciśnienia w drogach oddechowych, sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31-dotyczy Części nr 24, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 poz. 2 wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych i intubacyjnych z portem do podawania tlenu (wysoka skuteczność nawilżania ≥ 26 mg H₂O/L dla vt 50 ml, waga 8g) z końcówką pasującą do maski tlenowej z drenem, z zabezpieczeniem zapobiegającym uduszeniu pacjenta przy wzroście ciśnienia w drogach oddechowych, sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32-dotyczy Części nr 32, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w jakiej technologii jest pomiar saturacji ?

Odpowiedź: Technologia NELLCOR.

Pytanie 33-Dotyczy Części nr 14, poz. 1,2,3,4,5,6,i7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Części 14, poz. 1,2,3,4,5,6 i 7 cewników centralnych o następujących parametrach:

Poz. 1.Cewnik centralny jednoświatłowy dla dorosłych 18G, 20 cm. Zestaw, cewnik centralny z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, bez koreczka zamykającego, strzykawka trzyczęściowa nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2.Cewnik centralny dwuświatłowy 14.18Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw bez powłoki hydrofilnej, Ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa nie niskooporowa 5ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3.Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 8 F/ 20cm - zestaw –cewnik centralny z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa, nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4.Cewnik centralny trójświatłowy

16.18.18Ga/ 7 F/ 20cm –zestaw - centralny z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa, nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5.Cewnik centralny trójświatłowy

16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw - z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa, nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 6.Cewnik centralny czteroświatłowy

18,14,18,16 Ga/ 8,5 F/ 20cm – zestaw – z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa, nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 7.Cewnik centralny czteroświatłowy

18,14,18,16Ga/ 7 F/ 20cm – zestaw – z poliuretanu bez powłoki hydrofilnej, ilość koreczków o jeden mniejsza niż ilość świateł, strzykawka trzyczęściowa, nie niskooporowa 5 ml; bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34- dotyczy wzoru umowy

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 1.3) wzoru umowy w następujący sposób:

„dopuszcza się zmianę stawki VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen netto.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Brak jest podstaw by zmiana stawki VAT miała wpływać na cenę towaru przed opodatkowaniem.

Odpowiedź: NIE .Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: *„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”* Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust.5 wzoru umowy jak poniżej:

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”

3. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. a) oraz b) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką/ wartości braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §10 ust. 1 pkt. c) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia.

Odpowiedź: : NIE. Zgodnie z SIWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”*

Odpowiedź: : NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35-dotyczy Części nr 16, poz. 4

1. Czy Zamawiający w Części 16 poz. 4 wymaga szczoteczek odpowiadającym wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zgodnie z którymi szczoteczki cytologiczne powinny posiadać wykaz badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. § 3 pkt 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Części 16 poz.4 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36-dotyczy Części Nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dreny i butelki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny i butelki pochodzące od różnych producentów.

Pytanie 37-dotyczy Części Nr 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kontrolą odsysania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38-dotyczy Części Nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki niejałowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczotki niejałowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 39-dotyczy- wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego

Odpowiedź: : NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40-dotyczy- wzoru umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 1 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznają się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: : NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41-dotyczy- wzoru umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odpowiedź: : NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42-dotyczy - Część 1, poz. 10,11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do pompy o poj. 50/60 ml Luer Lock z płynnym przesuwem tłoka, posiadającej zabezpieczenie przed przypadkowym wypadaniem tłoka, z czterostronnym podcięciem tłoczyska co umożliwi stabilne zamocowanie strzykawki w pompie z podziałką co 2ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43-dotyczy - Część 1, poz. 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do pena w rozmiarze 0,25-0,36x8-12,7?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły do pena w rozmiarze 0,25-0,36x8-12,7.

Pytanie 44-dotyczy - Część 3, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czystego.

Pytanie 45-dotyczy - Część 11, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika typu mieszek o poj. 150 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46-dotyczy - Część 12, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poj. 20 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47-dotyczy - Część 23, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do pomiaru poziomu glikemii, który może zawyżać poziom glukozy we krwi jeśli stężenie poziomu galaktozy jest wyższe od 10mg/dl, stężenie poziomu maltozy powyżej 13 mg/dl we krwi. Natomiast w stężeniu poniżej wskazanych poziomów poszczególnych węglowodanów nie zachodzi interferencja tych węglowodanów w oznaczanym poziomie glukozy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48-dotyczy - Część 24, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika o skuteczności nawilżania >26 mg H₂O/l z czwórdzielną zastawką i odstąpi od wymogu celulozowego wkładu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49-dotyczy- Części Nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igły j.u. do iniekcji w rozmiarze 0,45 x 22?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły j.u. do iniekcji w rozmiarze 0,45 x 22.

Pytanie 50-dotyczy- Części Nr 1, poz. 24

Czy Zamawiający ma na myśli dowolny rozmiar z zakresu czy wszystkie dostępne rozmiary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły do pena w rozmiarze 0,25-0,36 x 8-12,7.

Pytanie 51 -dotyczy Części nr 24, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności nawilżania ≥ 28 mg H₂O/l przy VT 500 (zamiast Vt 50)? Pragniemy nadmienić, iż światowi producenci filtrów oraz wymienników podają skuteczność nawilżania przy objętości oddechowej 500ml.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności nawilżania ≥ 28 mg H₂O/l przy VT 500 .

Pytanie 52 -dotyczy Części nr 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika bez czwórdzielnej zastawki uwalniania ciśnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53 –dotyczy- Części nr 1, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy skala na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54- dotyczy- Części nr 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 55- dotyczy-Części nr 1, poz. 7, 11-12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać nazwę własną strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu poprawnej i pełnej identyfikacji w menu pompy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56 –dotyczy- Części nr 1, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 ml. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o pojemności 50 ml.

Pytanie 57- dotyczy-Części nr 1, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml luer–lock bez wycięcia na tłoku, wpisanej do oryginalnych instrukcji menu większości pomp strzykawkowych m.in. Ascor, Fresenius,

Braun, Terumo, Medima co zapewnia pełną kompatybilność strzykawek z pompą i bezawaryjne, bezpieczne podawanie leku, tak jak obecnie dostarczane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58 – dotyczy-Części nr 1, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego takich jak Ascor, Arcomed, Fresenius, Medima w celu zachowania kompatybilności strzykawek? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59 – dotyczy-Części nr 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm.

Pytanie 60- dotyczy-Części nr 1, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu potwierdzenia kompatybilności igieł do pena z istniejącymi na rynku różnymi typami wstrzykiwaczy, Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia do oferty stosowanego certyfikatu potwierdzającego kompatybilność, opierającego się na przeprowadzonych badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61-dotyczy-Części nr 1, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły sterylizowane radiacyjnie.

Pytanie 62- dotyczy-Części nr 1, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga kolorystycznego kodowania, tak jak w przypadku igieł iniekcyjnych, w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63 – dotyczy-Części nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający używając określenia Neoflon ma na myśli kaniulę dożylną 26 i 24 G wykonaną z PTFE, tak jak dotychczas stosowana w Państwa Szpitalu. Pragniemy nadmienić, iż rozmiary 26G i 17G przeznaczone dla noworodków i dzieci wykonane są z teflonu, ponieważ poliuretan jest materiałem zbyt miękkim, by móc bezpiecznie, za pierwszym razem włożyć się przez twardszą (posiadająca więcej włókien kolagenowych) skórę noworodka, naraża to zatem małego pacjenta na kilkakrotne wkłucie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64 – dotyczy-Części nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie pozbawione celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65- dotyczy-Części nr 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniul z przepływem 13ml co zapobiega przewodnieniu pacjenta, jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu?

Odpowiedź: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi ze względu na brak określenia czasu przepływu w Części Nr 4 ,poz. 1,2 do SIWZ.

Pytanie 66 – dotyczy-Części nr 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul j.u. Combi innego wytwórcy, produkowanych na zlecenie dla tego samego producenta co kaniule w pozycji 1 i 2, co zapewnia ich pełną kompatybilność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki do kaniul j.u. Combi innego wytwórcy, produkowanych na zlecenie dla tego samego producenta co kaniule w pozycji 1 i 2, co zapewnia ich pełną kompatybilność.

Pytanie 67 – dotyczy- Części nr 8, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego 1,2µm do żywienia pozajelitowego o przepływie 30ml/min., objętości wypełnienia 0,6ml, powierzchni filtrowania 1,6cm², sterylizowanego tlenkiem etylenu, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68- dotyczy-Części nr 8, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego 0,2µm do przetaczania płynów infuzyjnych o przepływie 2ml/min., objętości wypełnienia 0,6ml, powierzchni filtrowania 1,6cm², sterylizowanego tlenkiem etylenu, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69 – dotyczy-Części nr 12, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy maska z nebulizatorem ma rozbijać cząstki nebulizowanej substancji do objętości 3-5 mikronów, co gwarantuje największą skuteczność depozycji leku w płucach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70 – dotyczy- Części nr 12, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°)- posiadać antyprzelewową konstrukcję o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku) i czy ma być skalowany co 1 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71- dotyczy-Części nr 12, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania do pobierania wydzieliny o pojemności 25 ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72-dotyczy-Części nr 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista pomyłka i zamawiający ma na myśli martwą przestrzeń- rurę karbowaną jednorazowego użytku? Pragniemy nadmienić iż martwe przestrzenie silikonowe przeznaczone są do sterylizacji, czyli wielokrotnego użycia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Części nr 15, poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Martwa przestrzeń – rurka karbowana, silikonowana, jednorazowego użytku, o dł. 150÷200mm, z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F, z portem do odsysania 22F i bronchoskopu, z kapturkiem uszczelniającym, mikrobiologicznie czysta z silikonową zatyczką, otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu”.

Pytanie 73 –dotyczy-Części nr 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki karbowanej, martwej przestrzeni wykonanej z medycznego PCV, bez kapturka uszczelniającego, z zatyczką wykonaną z PCV, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74- dotyczy- Części nr 24, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych i intubacyjnych o kształcie walcowatym, waga 6,3g, z czterodzielną zastawką, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75 – dotyczy-Części nr 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych i intubacyjnych o wadze 6,3g, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76 -dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej ewentualną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77 –dotyczy-Części 1, poz. 3-6

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania strzykawk z rozszerzoną skalą pomiarową ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78 –dotyczy- Części 1, poz. 11, 12

Prosimy Zamawiającego o podanie z jakimi pompami mają współpracować oferowane strzykawki oraz dopuszczenie strzykawk wymienionych w instrukcji obsługi pompy. Jeżeli producent pompy dopuszcza używanie danej strzykawki to Zamawiający nie musi wprowadzać dodatkowych opisów ograniczających jedynie uczciwą konkurencję, np. w postaci nacięcia do mocowania w pompie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79- dotyczy- Części 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, produkcji Karasiński ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, produkcji Karasiński.

Pytanie 80 -dotyczy -części 12, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie pojemnika 20ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81 – dotyczy-Części nr 14, poz. 1

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 1 dopuści cewnik wprowadzany metodą Seldingera, z liniami kontrastującymi w rtg. Średnica wewnętrzna 1,0 mm i zewnętrzna 1,5mm długość 20 cm. W skład zestawu wchodzi dodatkowo: przewodnik typu „J” dł. 46 cm i średnicy 0.7 mm, dylatator, strzykawka 10ml, igła do nakłucia, dren przedłużający zakończony kranikiem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82 – dotyczy-Części nr 14, poz. 2

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 2 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu „J” dł. 53 cm i średnicy 0.9 mm, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7F i długości 20 cm. Kanały 16G /16G. W skład zestawu wchodzi: skalpel, dylatator, przewodnica typu „J” igła wprowadzająca 70mm, 2 zatyczki do dostrzykiwania, strzykawka 5 ml, skrzydełka mocujące, kaniula I.V 18G 64mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83 – dotyczy-Części nr 14, poz. 3

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 3 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu „J” dł. 53 cm i średnicy 0.9 mm , widoczny w Rtg, o rozmiarze 8F i długości 20 cm. Kanały 16G /16G. W skład zestawu wchodzi: skalpel, dylatator, igła wprowadzająca 70mm, 2 zatyczki do dostrzykiwania, strzykawka 5 ml, skrzydełka mocujące, kaniula I.V 18G 64mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84 – dotyczy-Części nr 14, poz. 4

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 4 dopuści trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu „J” dł. 53 cm i średnicy 0.9 mm, widoczny w Rtg, długości 20 cm. Kanały 14G-18G-18G. W skład zestawu wchodzi: skalpel, dylator, igła wprowadzająca 70 mm, 3 zatyczki do dostrzykiwania, strzykawka 5 ml, skrzydełko mocujące, kaniula I.V 18G 64mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85 – dotyczy-Części nr 14, poz. 5

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 5 dopuści trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu „J” dł. 80 cm i średnicy 0.9 mm, widoczny w Rtg, o długości 30 cm. Kanały 14G-18G-18G W skład zestawu wchodzi: skalpel, dylator, igła wprowadzająca 70mm, 3 zatyczki do dostrzykiwania, strzykawka 5 ml, skrzydełko mocujące, kaniula I.V 18G 64mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86 – dotyczy-Części nr 14, poz. 6,7

- czy zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji nr 6 i 7 dopuści czteroświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, przewodnik typu „J” dł. 68 cm i średnicy 0.88 mm , widoczny w Rtg, w rozmiarze 8,5 F o długości 20 cm. Kanały 14G-18G-18G. W skład zestawu wchodzi: skalpe, dylator, igła wprowadzająca 70mm, 4 zatyczki do dostrzykiwania, strzykawka 5 ml, skrzydełko mocujące, kaniula I.V 18G 64mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87 – dotyczy-wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 5 wzoru umowy dopisać słowa „*chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni*”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 7 ust. 5 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, dotychczasowa treść § 7 ust. 5 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z np. art. 552 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88 – dotyczy-wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy słowa „*pod warunkiem niezmienności cen brutto*” zostały zastąpione słowami „*pod warunkiem niezmienności cen netto*”?

Zwrot w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy „*pod warunkiem niezmienności cen brutto*” jest prawdopodobnie wynikiem omyłki Zamawiającego. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT musi spowodować zmianę ceny brutto; bez zmian może pozostać cena netto. Dlatego uzasadniona jest zmiana zapisu w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89 – dotyczy-wzoru umowy

Zważywszy na treść § 8 ust. 1 pkt 9) wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90 – dotyczy-wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy dodać podpunkt 14) o następującej (lub podobnej) treści: „*dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i*

usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91 – dotyczy-wzoru umowy.

O jakie konkretnie odpady chodzi w pkt 2.6 załącznika do umowy? Czy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, będzie zobowiązany do wywożenia odpadów z terenu Zamawiającego?

Odpowiedź: **Niniejszy punkt dotyczy tylko dostawców usług i robót budowlanych. Nie ma zastosowania w przypadku dostaw.**

Pytanie 92 – dotyczy-Części nr 8

1.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści filtr , którego objętość wypełnienia wynosi 0,4 mL?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtr , którego objętość wypełnienia wynosi 0,4 mL

2.Czy Zamawiający dopuści filtr bez zacisku szczelinowego?. Zacisk taki występuje w innym miejscu toru infuzyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3.Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści filtr posiadający linię długości 10 cm przed i 5 cm za filtrem?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 filtr o przepływie 30 ml/min.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5.Czy Zamawiający dopuści filtry sterylizowane tlenkiem etylenu ?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści filtr posiadający linię 3 cm przed i 3 cm za filtrem?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93 – dotyczy-Części nr 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarach: 0,25 do 0,33 x 6 do 12mm oraz 0,36 x 12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły do pena w rozmiarach: 0,25 do 0,33 x 6 do 12mm oraz 0,36 x 12mm?

Pytanie 94 – dotyczy-Części nr 28 poz. 4

Do pozycji nr 4 tj. Układ oddechowy przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany razem z komorą?. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o stosowną korektę do poz. nr 5 tj. komora nawilżacza?.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza układ oddechowy pakowany razem z komorą.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy winni uwzględnić w treści składanej oferty oraz formularzach asortymentowo-cenowych.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert umożliwiając Wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **24-09-2013 r. godz. 10:00**. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień: **24-09-2013 r. godz. 10:15**.

Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Jarosław Madowicz