



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 23.04.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**dostawę wyrobów do hemodializy
dla Ośrodka Dializ i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych.**
WSzS/DDZ/2411/P-8/023/.../12,

WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad wolnej konkurencji zezwoli, w zakresie części nr 1, na składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe, co pozwoli na start w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Gambro?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, w zakresie części nr 1 poz. 1 dopuści złożenie oferty z zestawami linii do aparatów Gambro AK, zgodnymi z załączonym schematem?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad wolnej konkurencji zezwoli, dokona podziału części nr 2 na dwa osobne pod pakiety 2a – poz. nr 1 i 2 oraz 2b, poz. 3 – 4, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający, w zakresie części 3, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi wiązką elektronów, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli oraz określi ilości poszczególnych rozmiarów zamawianych dializatorów, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferty i tym samym da Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej cenowo oferty?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający, w zakresie części 4, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi wiązką elektronów, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli oraz określi ilości poszczególnych rozmiarów zamawianych dializatorów, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferty i tym samym da Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej cenowo oferty?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający, w zakresie części 5, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi

sterylizowanymi wiązką elektronów, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli oraz określi ilości poszczególnych rozmiarów zamawianych dializatorów, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferty i tym samym da Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej cenowo oferty?

Możliwości dializatorów (in vitro)

	REXEED -13LX			REXEED -15LX			REXEED -18LX			REXEED - 21LX		
Przepływ krwi (ml/min)	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400
Klirens (ml/min)*	193	259	301	195	266	312	197	271	322	198	277	332
Mocznik												
Kreatynina	186	239	274	190	248	288	193	255	299	195	264	313
Fosforany	154	185	201	161	195	214	167	204	226	173	215	241
Witamina B12	93	102	106	100	110	116	107	118	125	115	129	137
KoA (Mocznik) (ml/min)	945			1064			1167			1321		
KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) *	9 (68)			10 (77)			12 (85)			14 (98)		
Efektywna powierzchnia (m ²)	1.3			1.5			1.8			2.1		

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową, TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min . *ISO8637:2004

Odpowiedź:

Jak w SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający, w zakresie części 6, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi wiązką elektronów, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli oraz określi ilości poszczególnych rozmiarów zamawianych dializatorów, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferty i tym samym da Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej cenowo oferty?

Możliwości dializatorów (in vitro)

	REXEED -13UX			REXEED -15UX			REXEED -18UX			REXEED - 21UX		
Przepływ krwi (ml/min)	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400
Klirens (ml/min)*												
Mocznik	196	267	315	197	273	326	198	279	335	199	284	345
Kreatynina	186	246	284	192	255	298	195	263	310	197	272	324
Fosforany	181	229	260	186	240	274	189	250	286	193	260	301
Witamina B12	138	160	173	147	173	188	154	184	201	163	199	216
KoA (Mocznik) (ml/min)	1083			1214			1382			1569		
KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) *	56 (421)			63 (470)			70 (521)			80 (598)		
Efektywna powierzchnia (m ²)	1.3			1.5			1.8			2.1		
Współczynnik przenikania – β ₂ -MG*	0,70											
Współczynnik przenikania – Albumina*	≤ 0,002											

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową, TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min.


*ISO8637:2004

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości dializatorów japońskiej firmy ASAHI, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź:

Jak w SIWZ.

As confirmation, 1) date, 2) signature and 3) company stamp please.

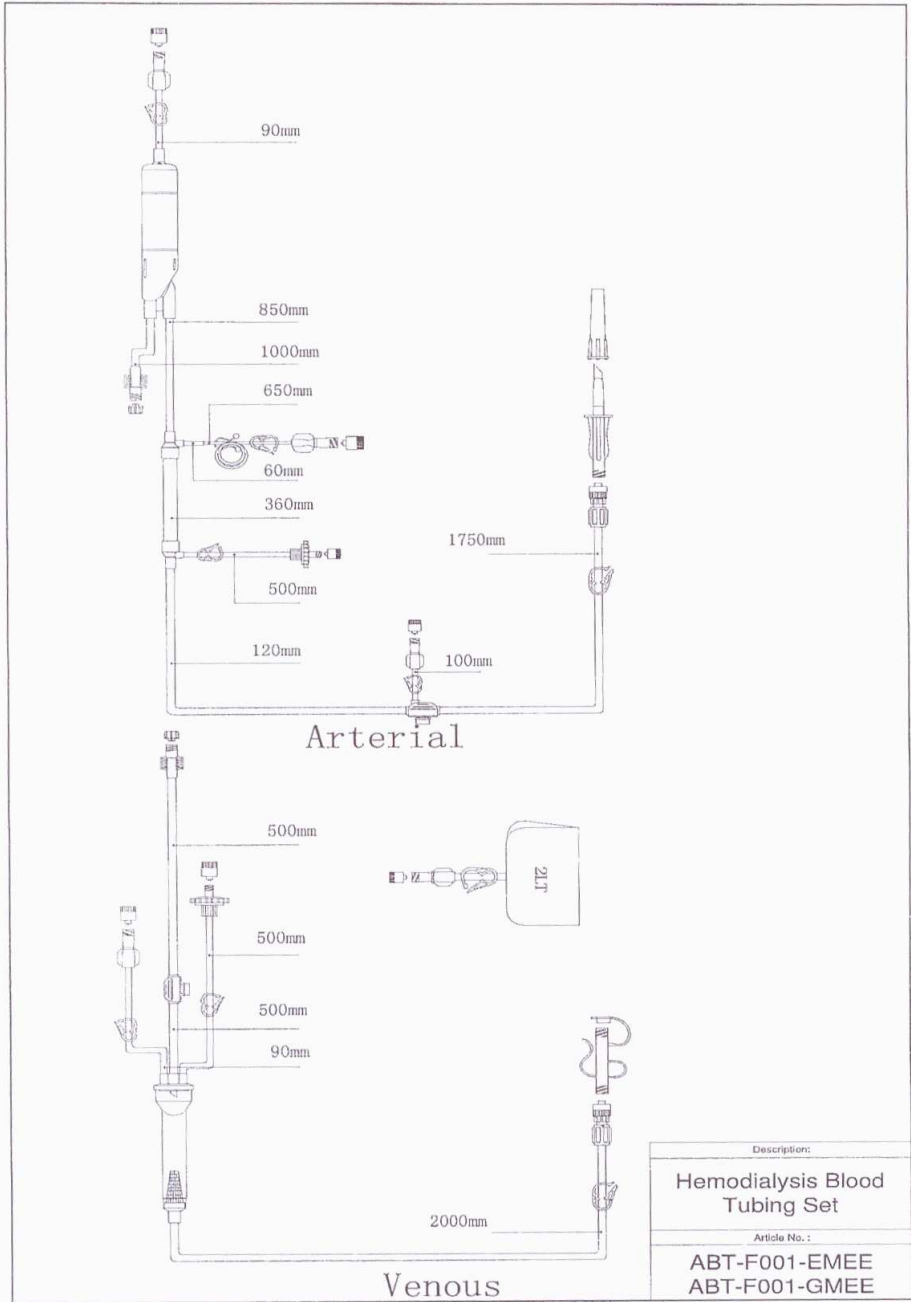

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 3 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami Gamma o powierzchni 1,0m², 1,2m², 1,5m², 1,8m², 2,0m², 2,3m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 4 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami Gamma o powierzchni 1,5m², 1,8m², 2,0m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 5 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami Gamma o powierzchni 1,2m², 1,5m², 1,8m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 6 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami Gamma o powierzchni 1,5m², 1,8m², 2,3m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 7 środka na bazie kwasu cytrynowego w kanistrach a 6L.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 koncentratów do hemodializy w kanistrach a 6L.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy w zakresie Części nr 10, pozycja nr 1,3 i 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do hemodializy bez oznaczenia średnicy kanałów wewnętrznych za pomocą miary Ga?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy w zakresie Części nr 10, pozycja nr 1, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników permanentnych do metody tunelizacji następczej (anterograde) o średnicy zewnętrznej 14,5 Fr w zakresie długości cewników 24,28,32,36,37 oraz 47cm gwarantujących przepływ 500ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy w zakresie Części nr 10, pozycja nr 3 i 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długościach 15 i 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Czy w zakresie Części nr 10, pozycja nr 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnic do cewników zaoferowanych w pozycji 1,3 i 4 o długości 70cm i średnicy zewnętrznej 0,97mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 3 zapisu: "Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie"?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 7 ustęp 3 zapisu „otrzymania...” na „wystawienia faktury VAT”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 7 ust. 4 : „Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej Umowy, przekroczy 60 dni od dnia wymagalności należności”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 7 ustępu 5?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22 - dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie 8 ustęp 2 umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

b) zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

Odpowiedź: Tak, proponowana zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę.

c) Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

ZATWIERDZIŁ:

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Bronisław Morawiecki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz