



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 12.06..2013r.

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

### WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:  
**DOSTAWĘ WYROBÓW DO HEMODIALIZY**

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/038/1551/13

### WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### **Pytanie 1 – Części Nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie dializatorów polisulfonowych, niskoprzepływowch, o zadanych powierzchniach 1,3m<sup>2</sup>, 1,6m<sup>2</sup>, 1,8m<sup>2</sup>, sterylizowanych parą wodną?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza dializatory sterylizowane parą wodną.**

#### **Pytanie 2 – dotyczy wzoru umowy, §8, pkt 1, ppkt 3**

Czy Zamawiający zmieni w/w punkt, zaznaczając możliwość zmiany ceny brutto, w wypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 3 – dotyczy wzoru umowy, §8 ust. 1,3)**

Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 1.3) wzoru umowy w następujący sposób:

*„dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot Zamówienia, w takim przypadku wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru w trybie pilnym do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.**

#### **Pytanie 5 - dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 5**

Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: *„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 6 - dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 6**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie 7 - dotyczy wzoru umowy, §10 ust. 1 pkt a)**

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. a) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8 - dotyczy wzoru umowy, §10 ust. 1 pkt c)**

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §10 ust. 1 pkt. c) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.**

**Pytanie 9 - dotyczy wzoru umowy, §10 ust. 4**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 10 - dotyczy wzoru umowy, §6 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w §6 ust. 2 wzoru umowy „dni robocze”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.**

**Pytanie 11 - dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 6**

Załącznik nr 6 SIWZ zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, co do którego zapadnie decyzja o wyborze oferty. Zgodnie z § 7 ust. 6 umowy Wykonawca podczas jej wykonywania, a konkretnie podczas wykonywania swoich uprawnień wynikających z zawarcia umowy z Zamawiającym nie może udzielić pełnomocnictwa innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tj. firmie windykacyjnej. Dosłowna treść tego postanowienia umowy uniemożliwia udzielenia pełnomocnictwa jakiegokolwiek firmie, w tym również firmie zajmującej się usługami prawnymi – w tym kancelarii adwokackiej czy radcowskiej – są to również niewątpliwie firmy (prowadzone w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego).

Nadto wnoszę o wskazanie podstawy prawnej pozwalającej na umowne ograniczenie dyspozycji przepisu art. 95 § 1 k.c., zgodnie z którym „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianej albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności przez przedstawiciela.” Jak wynika z zacytowanego przepisu ograniczenia w możliwości udzielenia pełnomocnictwa muszą wynikać jedynie z ustawy lub właściwości czynności prawnej, nie przewidują natomiast możliwości umownego ograniczenia sfery możliwości działania osoby fizycznej czy prawnej w ten sposób, by czynności prawnych musiała dokonywać osobiście lub przez wybranego jedynie przedstawiciela. Należy przy tym zauważyć, że jeżeli już ustawodawca pragnie ograniczyć krąg pełnomocników czyni to wyraźnie, przykładowo wprowadzając przymus adwokacki w niektórych postępowaniach (np. skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym). W tej sytuacji umowne ograniczenie kręgu pełnomocników jedynie do osób nieprowadzących działalności gospodarczej (w praktyce: osób fizycznych, stowarzyszeń i fundacji) wykracza poza granice swobody umów zakreślone przepisem art. 353 (1) k.c. jako sprzeczne z ustawą (wspomniany art. 95 § 1 k.c.) jak też z właściwością stosunku prawnego, skoro w sferze działania przedsiębiorców posługiwanie się wyspecjalizowanymi pełnomocnikami należy do standardu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ograniczenia jak w § 7 ust. 6 proponowanej treści umowy?

**Odpowiedź:**

**Nie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wyłącza możliwości udzielenia pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu.**

**Pytanie 12 - dotyczy Części Nr 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 3 dializatorów polisulfonowych, sterylizowanych promieniami Gamma o następujących powierzchniach: 1,0 m<sup>2</sup>, 1,2 m<sup>2</sup>; 1,5 m<sup>2</sup>, 1,8 m<sup>2</sup>, 2,0 m<sup>2</sup>, 2,3 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 13 - dotyczy Części Nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 4 dializatorów polisulfonowych, niskoprzepływowch, sterylizowanych promieniami Gamma o następujących powierzchniach: 1,5 m<sup>2</sup>, 1,8 m<sup>2</sup>, 2,0 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 14 - dotyczy Części Nr 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 5 dializatorów polisulfonowych, niskoprzepływowch, sterylizowanych promieniami Gamma o następujących powierzchniach: 1,2 m<sup>2</sup>, 1,5 m<sup>2</sup>, 1,8 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 15 - dotyczy Części Nr 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 6 dializatorów polisulfonowych, wysokoprzepływowych, sterylizowanych promieniami Gamma o następujących powierzchniach: 1,5 m<sup>2</sup>, 1,8 m<sup>2</sup>, 2,3 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 16 - dotyczy Części Nr 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 7, gotowego środka do dezynfekcji w kanistrach o pojemności 6L. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 17 - dotyczy Części Nr 10**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 10, pozycji nr 3 i utworzenie odrębnego zdania.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 18 - dotyczy Części Nr 11**


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 11, koncentratów do hemodializy w kanistrach 6L. Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 19 - dotyczy Części Nr 1**

*Czy Zamawiający, wyłączając z części nr 1 poz. 1 i utworzy z niej osobny pod pakiet oraz dopuści złożenie oferty z liniami do hemodializy zgodnymi z poniższym schematem, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stację Dializ?*

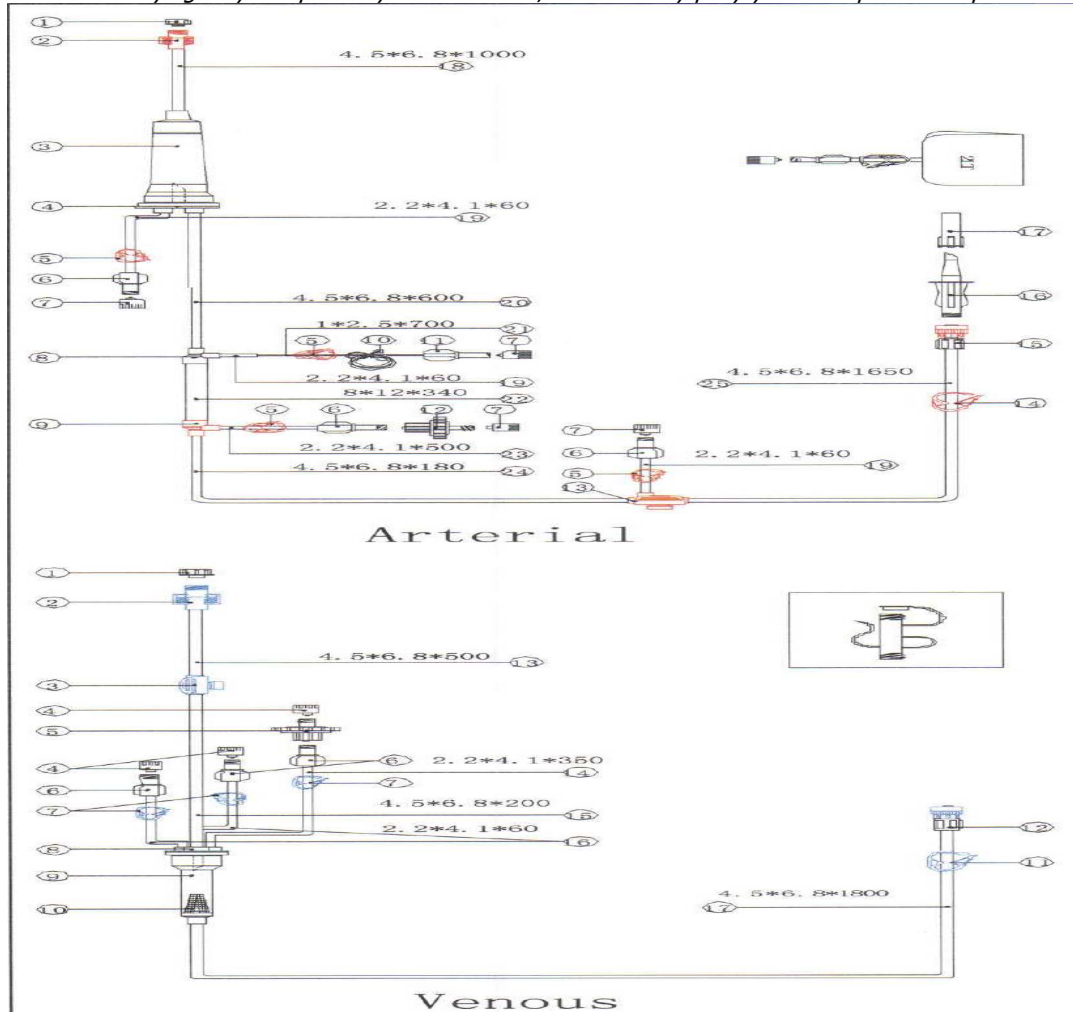

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 20 - dotyczy Części Nr 2**

*Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasady wolnej konkurencji, dokona podziału części nr 2 dwa osobne pod pakiety 2a – Linie tętniczo żyłne do aparatów Fresenius 4008 (poz. 1 i 2) oraz 2b – poz. 3 i 4, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami i zaferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych, używanych w wielu Stacjach Dializ na terenie całego kraju?*

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 21 - dotyczy Części Nr 2**

Czy Zamawiający w zakresie części 2, poz. 1 dopuści złożenie oferty z kompletami linii tętniczo żylnych do aparatu Fresenius 4008 o następującym składzie: linia żylna i linia tętnicza, worek do odbioru płyny 2l, łącznik żyła tętnicza, dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, testowanymi z pozytywnym wynikiem przez Stację Dializ Zamawiającego?

**Odpowiedź:****Zgodnie z SIWZ****Pytanie 22 - dotyczy Części Nr 5**

Czy Zamawiający w zakresie części 5, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi radiacyjnie o powierzchniach 1,3m<sup>2</sup>, 1,5m<sup>2</sup> oraz 1,8m<sup>2</sup> i charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

**Możliwości dializatorów (in vitro)**

	REXEED -13LX			REXEED -15LX			REXEED -18LX			
	200	300	400	200	300	400	200	300	400	
Przepływ krwi (ml/min)	200	300	400	200	300	400	200	300	400	
Klirens (ml/min)*	193	259	301	195	266	312	197	271	322	
	Mocznik									
	Kreatynina	186	239	274	190	248	288	193	255	299
	Fosforany	154	185	201	161	195	214	167	204	226
	Witamina B12	93	102	106	100	110	116	107	118	125
KoA (Mocznik) (ml/min)	945			1064			1167			
KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) *	9 (68)			10 (77)			12 (85)			
Efektywna powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1.3			1.5			1.8			

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową, TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min . \*ISO8637:2004

**Odpowiedź:****Zgodnie z SIWZ****Pytanie 23 - dotyczy Części Nr 9**

Czy Zamawiający w zakresie części 9 poz. 2 dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy na jedno wklucie sterylizowanymi tlenkiem etylenu lub też wydzieli w/w pozycję do osobnego podpakietu?

**Odpowiedź:****Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 24 - dotyczy Części Nr 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego zamkniętego systemu o przepływie 525 ml/min, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:****Zamawiający dopuszcza przepływ 525 ml/min****Pytanie 25 - dotyczy Części Nr 14**

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań klinicznych potwierdzających możliwość użycia systemu bezigłowego w czasie minimum 3 kolejnych dializ w okresie 7 dni i dopuszczenie oświadczenia Producenta w tym zakresie.

**Odpowiedź:****Zgodnie z SIWZ****Pytanie 26 - dotyczy Części Nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 11 poz. 2 składnika zasadowego – a 9 litrów – bicarbonat 8,4%?

**Odpowiedź:****Zgodnie z SIWZ**

ZATWIERDZIŁ:

Z-CA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA

LEK. MED. BRONISŁAW MORAWIECKI